


Корпус

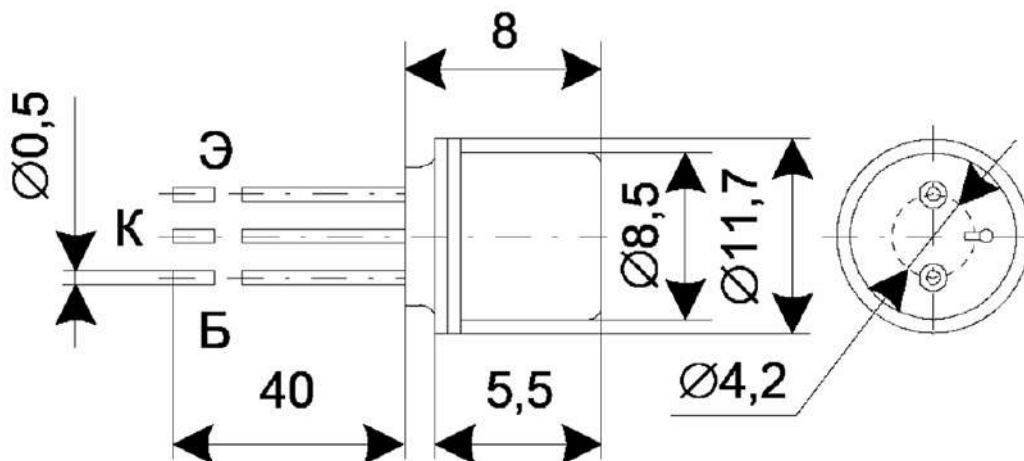

Транзисторы ПЗ07, ПЗ07А, ПЗ07Б, ПЗ07В, ПЗ07Г, ПЗ08 , ПЗ09

Тип прибора	Предельные значения параметров при $T_p = 25^\circ\text{C}$					Значения параметров при $T_p = 25^\circ\text{C}$					
	$I_{к.макс.}$ мА	$I_{к.и.макс.}$ мА	$U_{кэ.макс.}$ В	$U_{кб.макс.}$ В	$P_{к.макс.}$ мВт	$h_{21э}$	$U_{кб.}$ В	$I_{э.}$ мА	$U_{кэ.нас.}$ В	$I_{кбо.}$ мкА	$f_{гр.}$ МГц
ПЗ07	30	120	80	80	250	16...50	20	10	—	3	20
ПЗ07А	30	120	80	80	250	30...90	20	10	—	3	20
ПЗ07Б	15	120	80	80	250	50...150	20	10	—	3	20
ПЗ07В	30	120	60	60	250	50...150	20	10	—	3	20
ПЗ07Г	15	120	80	80	250	16...50	20	10	—	3	20
ПЗ08	30	120	120	120	250	30...90	20	10	—	3	20
ПЗ09	30	120	120	120	250	16...50	20	10	—	3	20